
Б'ЮТІФІЛ-Балк Флоубл

Текучий реставраційний матеріал (шприц)

Текучий пломбувальний матеріал, що виділяє

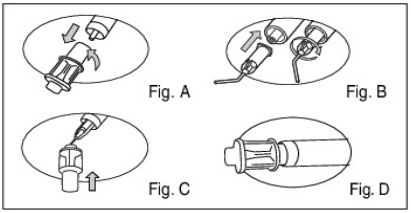

фтор і вноситься однією порцією

Б'ЮТІФІЛ-Балк Флоубл — це фотополімерний, рентгеноконтрастний, текучий, реставраційний матеріал. Його основним призначенням є використання як основи для реставрацій класів I та II. Матеріал можна наносити шарами завтовшки 4 мм. Б'ЮТІФІЛ-Балк Флоубл покривається універсальним матеріалом або матеріалом для жувальних зубів, який заміщує відсутню емаль в оклюзійній або вестибулярній зоні.

ВІДТІНКИ

Універсальний (U), дентин (D)

СКЛАД

Bis-GMA, UDMA, Bis-MPEPP, TEGDMA, наповнювач S-PRG на основі фторборалюмінійсилікатного скла, ініціатор полімеризації, барвники та ін.

ПОКАЗАННЯ

- Основа для прямих реставрацій класів I та II
- Лайнер під матеріали для прямих реставрацій
- Реставрації для невеликих порожнин жувальних зубів (включаючи зону оклюзії)

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Не використовуйте цей матеріал для лікування пацієнта, якщо відомо, що він має алергію на цей матеріал та/або на мономер метакрилату.
2. Цим матеріалом не повинен користуватися лікар, якщо відомо, що він має алергію на цей матеріал та/або на мономер метакрилату.
3. Якщо під час використання цього матеріалу в пацієнта або лікаря виникне подразнення або інші алергічні реакції, негайно припиніть роботу з матеріалом та зверніться по медичну допомогу.
4. Щоб уникнути підвищення чутливості до цього матеріалу, слід надягнути медичні (стоматологічні) рукавички й захисні окуляри. У разі випадкового потрапляння на м'які тканини ротової порожнини або на шкіру негайно промокніть ватним тампоном, змоченим у спирті, та промийте великою кількістю води. Медичні (стоматологічні) рукавички забезпечують певний захист від прямого контакту з цим матеріалом, але деякі мономери можуть дуже швидко проникнути крізь рукавички та потрапити на шкіру. Отже, у разі потрапляння матеріалу навіть на рукавички, негайно зніміть їх та вимийте руки великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води та зверніться по медичну допомогу.
5. Цим матеріалом мають користуватися лише спеціалісти зі стоматології.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

1. Очищення поверхні зуба
   Ретельно очистьте поверхню зуба від нальоту.
2. Вибір відтінку
   Поки зуб вологий, виберіть необхідний відтінок універсального матеріалу або матеріалу для реставрування жувальних зубів за допомогою відповідної шкали.
3. Препарування порожнини
   Відпрепаруйте порожнину стандартним методом.
4. Ізоляція
   Ізолюйте зону лікування, наприклад, кофердамом, щоб захистити її від контамінації.
5. Встановлення матриці
   Встановіть матрицю, якщо порожнина включає апроксимальну зону. Дотримуйтесь інструкції з використання матриці, яка надана її виробником.
6. Захист пульпи

Якщо пульпа відкрита, або уражена зона розташована близько до пульпи, покрийте пульпу, наприклад, гідроксидом кальцію.

7. Нанесення адгезиву
   Нанесіть адгезив для дентину відповідно до інструкції з використання, наданої виробником.
8. Введення
   Встановіть голкоподібну канюлю Б'ЮТІФІЛ за наведеною нижче інструкцією:
   - Зніміть захисний ковпачок, повільного його повернувши (рис. A).
   - Поверніть канюлю за годинниковою стрілкою, доки вона щільно не зафіксується (рис. B).
9. Нанесення
   Вносьте матеріал безпосередньо в порожнину, а саме, починаючи від дна і до рівня не менш ніж 2 мм нижче оклюзійної поверхні. Щоб не виникли повітряні бульбашки, під час заповнення порожнини поступово витягуйте канюлю. Якщо порожнина є дуже глибокою, наносьте матеріал шарами завтовшки по 4 мм.
10. Фотополімеризація
    Засвітіть кожний шар (завтовшки до 4 мм) галогеновою або світлодіодною полімеризаційною лампою.

Відтінок	Глибина полімеризації	Галогенова полімеризаційна лампа	Світлодіодна полімеризаційна лампа
Універсальний	4 мм	20 секунд	10 секунд
дентин		40 секунд	20 секунд

BEAUTIFIL-Bulk Flowable

Flowable Restorative material (syringe)

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Галогенова полімеризаційна лампа
  Довжина хвилі: 400-500 нм,
  інтенсивність випромінювання: ≥ 500 мВт/см^2
- Світлодіодна полімеризаційна лампа
  Довжина хвилі: 440-490 нм,
  інтенсивність випромінювання: ≥ 1000 мВт/см^2

11. Завершення реставрування

Нанесіть універсальний пломбувальний матеріал або матеріал для бічних зубів безпосередньо на полімеризований Б'ЮТІФІЛ-Балк Флоубл. Після полімеризації виконайте контурування, фінірування або полірування реставраційної конструкції стандартним методом.

ПРИМІТКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Використовуйте стоматологічну полімеризаційну лампу з технічними характеристиками, які еквівалентні тим, що зазначені вище. Якщо технічні характеристики лампи відрізняються від рекомендованих, дотримуйтесь інструкції з використання лампи, щоб якісно засвітити матеріал Б'ЮТІФІЛ-Балк Флоубл.
2. Лікар повинен користуватися захисними окулярами або захисним екраном, щоб не дивитися безпосередньо на світло полімеризаційної лампи. Також лікар має подбати про захист очей пацієнта від цього світла.
3. Не застосовуйте матеріали, що містять евгенол, оскільки це може погіршити полімеризацію й адгезію матеріалу.
4. Канюлі необхідно використовувати тільки для лікування одного пацієнта й утилізувати після лікування, щоб не допустити перехресної контамінації.
5. Спочатку утилізуйте канюлю, а вже потім підготуйте шприц до зберігання. Щоб підготувати матеріал до зберігання, надягніть чисті рукавички та зробіть одну з двох вказаних нижче дій:
   - Закріпіть нову канюлю. Вставте канюлю у вузький отвір на верхівці захисного ковпачка та щільно її закріпіть (рис. C).
   - Щільно закріпіть захисний ковпачок (рис. D).
6. Очистьте та продезінфікуйте шприц і ковпачок за допомогою, наприклад, спирту й марлевої серветки. Коли видавите матеріал, щільно закрийте ковпачок. Під час стерилізації слідкуйте за тим, щоб спирт не потрапив у матеріал. Полімеризаційну лампу також необхідно очистити й обробити спиртом.
7. У разі використання стоматологічних матеріалів або інструментів разом із цим виробом дотримуйтеся відповідних інструкцій з використання.
8. У разі зберігання матеріалу в холодильній камері використовуйте його тільки після того, як він нагріється до кімнатної температури.
9. Не використовуйте цей матеріал для здійснення будь-яких дій, окрім зазначених у тексті цієї інструкції.
10. Використайте цей матеріал до закінчення терміну придатності, вказаного на пакувальних матеріалах і на контейнері.

(Приклад: PPPP-ММ-ДД --> рік, місяць і день закінчення терміну придатності.)

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте в темному місці, в умовах кімнатної температури (1-30 °C / 34-86 °F). Не допускайте впливу високої температури та високої вологості. Захищайте від впливу прямих сонячних променів і зберігайте подалі від джерел займання.

Вміст паковання: 1 шприц 2.4 г, голкоподібні канюлі 5 шт.

MD	Медичний виріб
Rx only	Рецептурний препарат
	Гранична температура
	Захищайте від впливу сонячного проміння
	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Використати до
REF	Артикул
LOT	Номер партії
	Виробник
	Одноразові канюлі
	Дата виробництва

ШОФУ ІНК.
11 Камітакамацу-чо, Фукуіне,
Хігашияма-ку, Кіото 605-0983, Японія
www.shofu.com

Виготовлено в Японії

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

UA.TR.137

Дата перегляду інструкції: 07/2024